IHR LOGO

Läsionsreport ERSTELLT AM 27.04.2021, 09:34:12

mdbrain v.4.0.0

PATIENTEN ID	NAME	GESCHLECHT	GEBURTSDATUM	UNTERSUCHUNGSDATUM	SEQUENZ(EN)
MR784514	Max Mustermann	M	01.01.1990 (29J)	01.01.2019 *Eine vorherige Untersuchung berücksichtigt.*	t1 (T1) ... (+3)

Läsionsveränderungen: Exemplarische Darstellung der Schichten

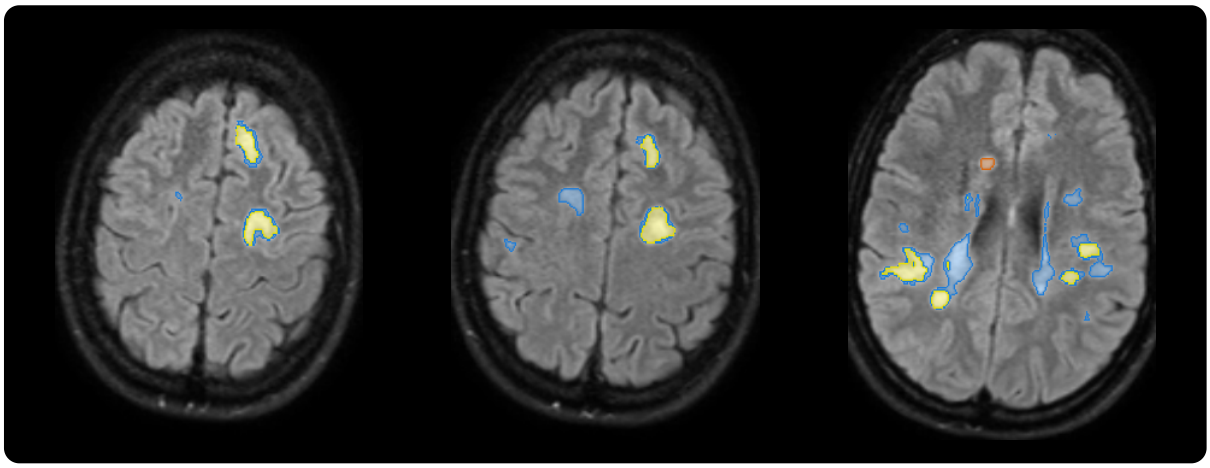

- Neu
- Vergrößert
- Alt

Räumliche Verteilung der Läsionen

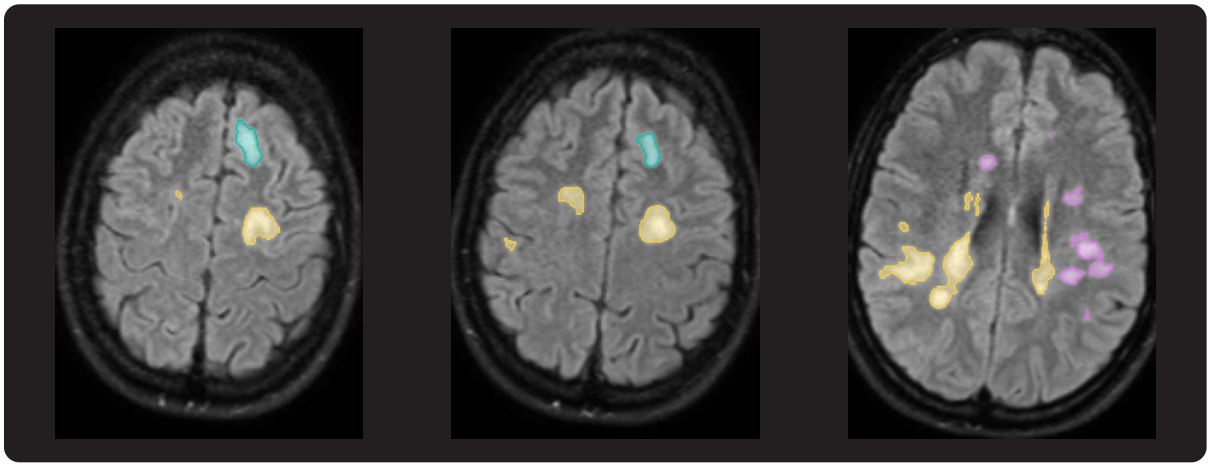

- Periventrikulär
- Juxtakortikal
- Infratentoriell
- Übriges Marklager

Details

	LÄSIONSVOLUMEN [ml]			ANZAHL LÄSIONEN		
REGION	01.01.2019	NEU*	VERGRÖSSERT^Δ	01.01.2019	NEU*	VERGRÖSSERT^Δ
PERIVENTRIKULÄR	17,43	0,00	5,26	5	0	3
JUXTAKORTIKAL	1,83	0,00	1,19	2	0	2
INFRATENTORIELL	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ÜBRIGES MARKLAGER	6,34	0,91	2,08	18	5	6
GESAMT	**25,60**	**0,91**	**8,52**	**25**	**5**	**11**

Qualitätskontrolle (01.01.2019)

BILDQUALITÄT	Gut
ANMERKUNGEN	Siehe Appendix

Die von Ihnen verwendete Version von mdbrain ist eine Testversion, die kein Medizinprodukt ist und daher ausschließlich zu Testzwecken verwendet werden darf. Zur Installation der als Medizinprodukt freigegebenen Version wenden Sie sich bitte an support@mediaire.de

mediaire
mediaire GmbH info@mediaire.de
Möckernstraße 63, 10965 Berlin

IHR LOGO

Läsionsreport ERSTELLT AM 27.04.2021, 09:34:12

mdbrain v.4.0.0

PATIENTEN ID	NAME	GESCHLECHT	GEBURTSDATUM	UNTERSUCHUNGSDATUM	SEQUENZ(EN)
MR784514	Max Mustermann	M	01.01.1990 (29J)	01.01.2019 *Eine vorherige Untersuchung berücksichtigt.*	t1 (T1) ... (+3)

Appendix

TE der T1 Sequenzen sind verschieden. Dies kann die Zuverlässigkeit der longitudinalen Auswertung beeinträchtigen.

01.01.2019 SCAN

DICOM FELD	T1	T2/FLAIR
SEQUENCE DESCRIPTION	t1	t2
SCANNER MANUFACTURER	Philips	Philips
SCANNER TYPE	nifti2dicom	nifti2dicom
FIELD STRENGTH	1,5 T	1,5 T
REPETITION TIME	n/a	n/a
ECHO TIME	n/a	n/a
INVERSION TIME	n/a	n/a
PIXEL SPACING	1,0 mm x 1,0 mm	1,0 mm x 1,0 mm
SLICE THICKNESS	1,0 mm	1,0 mm
SPACING BETWEEN SLICES	1,0 mm	1,0 mm
ACQUISITION MATRIX	n/a	n/a
ANZAHL DER SCHICHTEN	None	None

01.01.2018 SCAN

DICOM FELD	T1	T2/FLAIR
SEQUENCE DESCRIPTION	t1	t2
SCANNER MANUFACTURER	Philips	Philips
SCANNER TYPE	nifti2dicom	nifti2dicom
FIELD STRENGTH	1,5 T	1,5 T
REPETITION TIME	n/a	n/a
ECHO TIME	n/a	n/a
INVERSION TIME	n/a	n/a
PIXEL SPACING	1,0 mm x 1,0 mm	1,0 mm x 1,0 mm
SLICE THICKNESS	1,0 mm	1,0 mm
SPACING BETWEEN SLICES	1,0 mm	1,0 mm
ACQUISITION MATRIX	n/a	n/a
ANZAHL DER SCHICHTEN	None	None

Die von Ihnen verwendete Version von mdbrain ist eine Testversion, die kein Medizinprodukt ist und daher ausschließlich zu Testzwecken verwendet werden darf. Zur Installation der als Medizinprodukt freigegebenen Version wenden Sie sich bitte an support@mediaire.de

mediaire
mediaire GmbH info@mediaire.de
Möckernstraße 63, 10965 Berlin